


# Exame n.º :730618


CPF :008.858.791-63	Paciente :Gilson da Silva Oliveira Santos	RG :15602362/SSP MT
CNPJ :02.480.196/0001-94	Razão :IMDEPA ROLAMENTOS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	
Nascimento :04/07/1986	Idade : 38 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :VENDEDOR	
Data do Exame : 04/04/2025		

### Orelha Direita

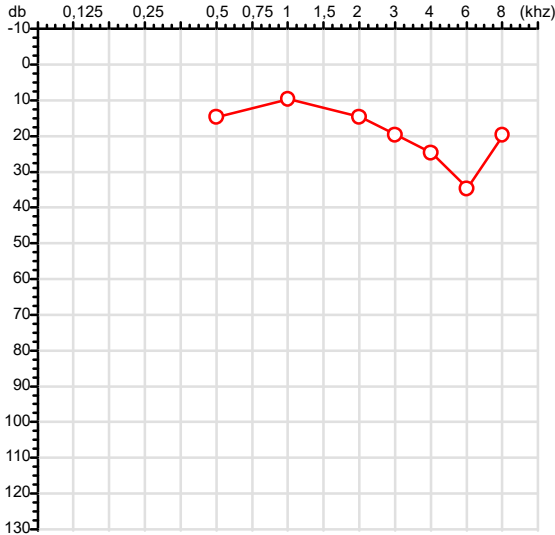

### Audiometria

### Orelha Esquerda

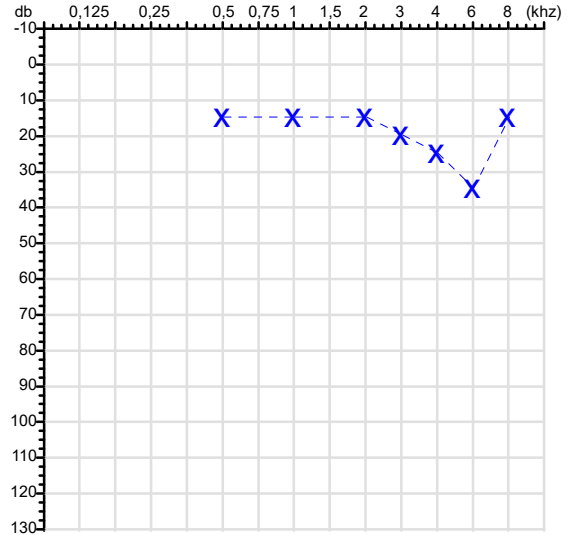

#### Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	20	25	35	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	35	15

#### Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

#### Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	20	25	35	27

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	35	27

#### Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

#### Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :1BA4A3202FE7905173275366146551DB  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Gilson da Silva Oliveira Santos*  
\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2024