
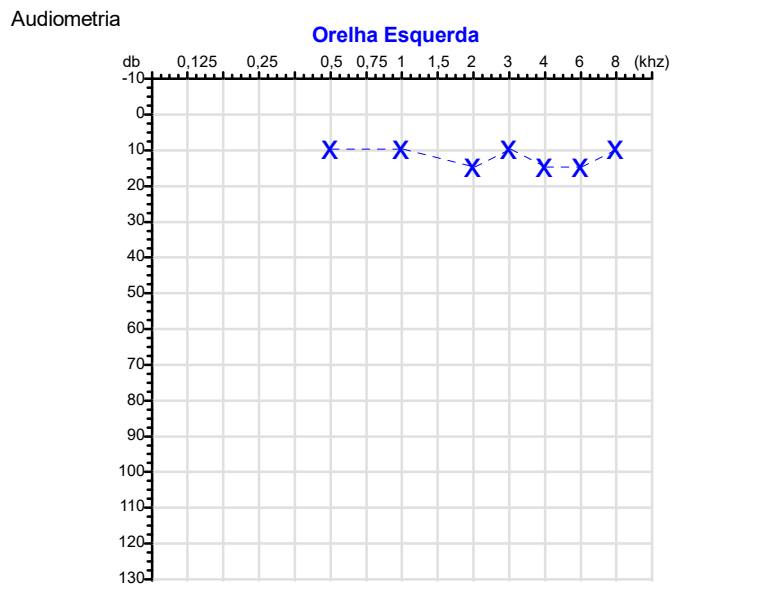


CPF :060.774.811-73	Paciente :Pedro Henrique Nascimento Pimenta	RG :28093542/SSP MT
CNPJ :03.545.453/0001-91	Razão :LATASA MS RECICLAGEM LTDA	
Nascimento :08/02/2003	Idade : 22 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR (A) DE PRODUCAO II	
Data do Exame : 12/09/2025		

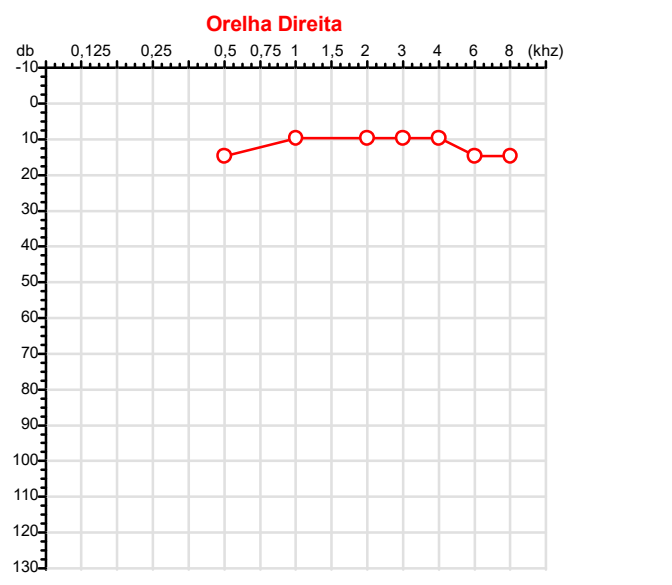

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	10	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	15	10	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	10	15	12

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	15	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OD
 Audição normal

Laudo Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :9C76CE5E8527620A6F9B59F213699C5E
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Pedro Henrique Nascimento Pimenta
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025