


# Exame n.º :777014

CPF :055.659.311-18  
CNPJ :09.130.029/0002-43  
Nascimento :04/04/1997  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 03/11/2025

Paciente :Maycon Patrick de Lima  
Razão :AGUIA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA  
Idade : 28 anos  
Setor :GERAL  
Função :MOTORISTA DE CARRETA

RG :/

## Orelha Direita

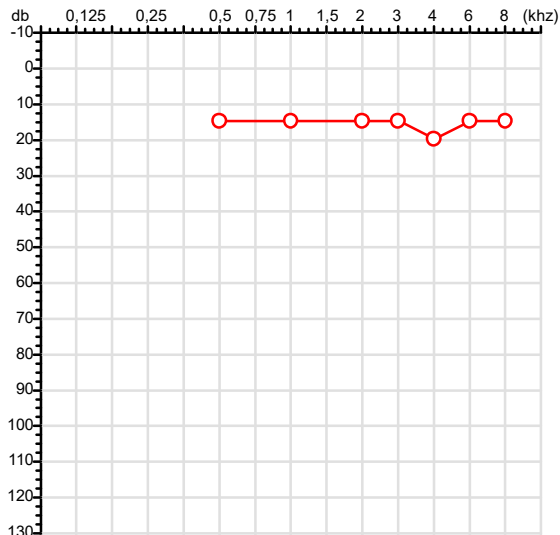

## Aérea

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |

## Óssea

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| Khaz  | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 17 |


## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda

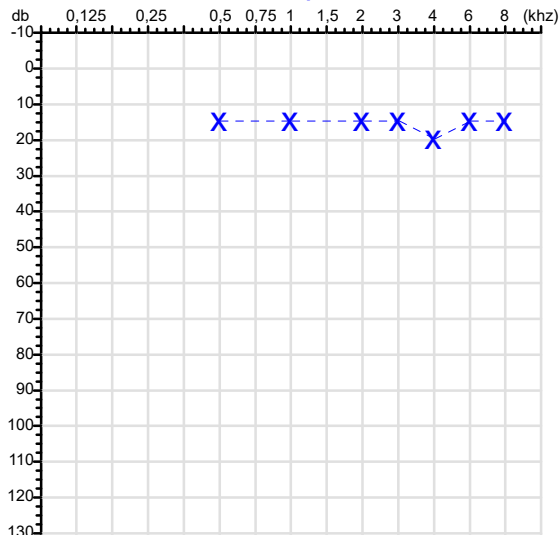

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khaz  | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 17 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes  
Médica  
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :23C8C77D5F98D63F99F8770A35FE2723

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Maycon Patrick de Lima

\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT  
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 03/11/2025  
Primeiro Nome: MAYCON PATRICK  
Sobrenome: LIMA  
Altura (cm): 174.0  
Peso (kg): 85.0

Data de nascimento: 04/04/1997  
Sexo : Macho  
Descrição:  
Empresa:  
Fuma: Não

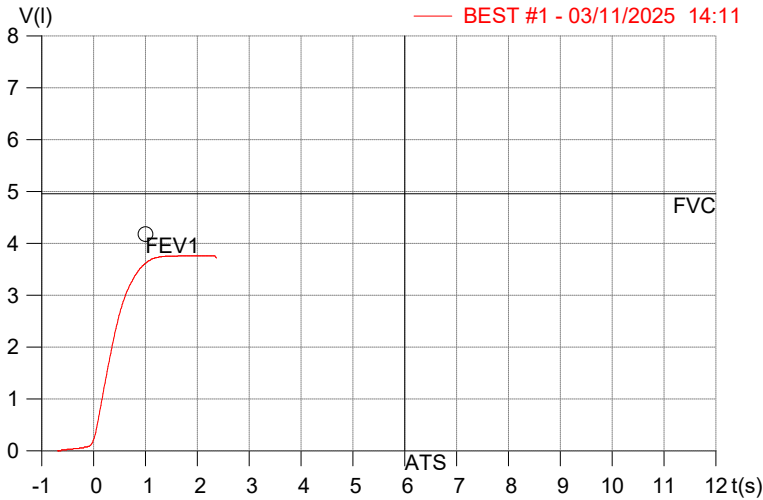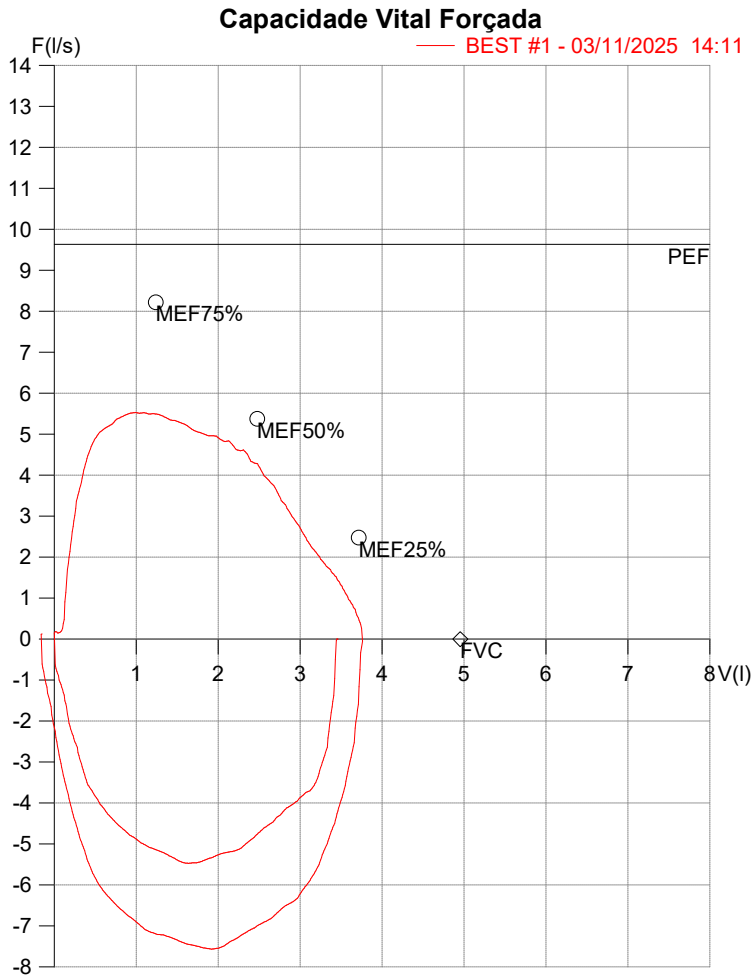

| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.95  | 3.77   | 76.2    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.95  | 3.77   | 76.2    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 4.18  | 3.61   | 86.4    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 9.63  | 5.53   | 57.4    |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 7.57   |         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 82.2  | 95.7   | 116.5   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.87  | 4.75   | 97.5    |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 8.22  | 5.52   | 67.1    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 5.38  | 4.96   | 92.3    |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.47  | 3.28   | 132.5   |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.6    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 577.8 | 331.6  | 57.4    |

**Diagnóstico:**  
Anormalidade MODERADO