



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561      Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4      N.º S/N

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ / MT      CEP : 78098970

### Funcionário

Nome : Gilmar de Souza Rodrigues

Setor: GHE 16 CARREGAMENTO - OPERADOR DE GUINDASTE

CPF : 00694462101

Cargo: OPERADOR DE GUINDASTE

RG : /

Nascimento: 02/06/1982

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 17 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

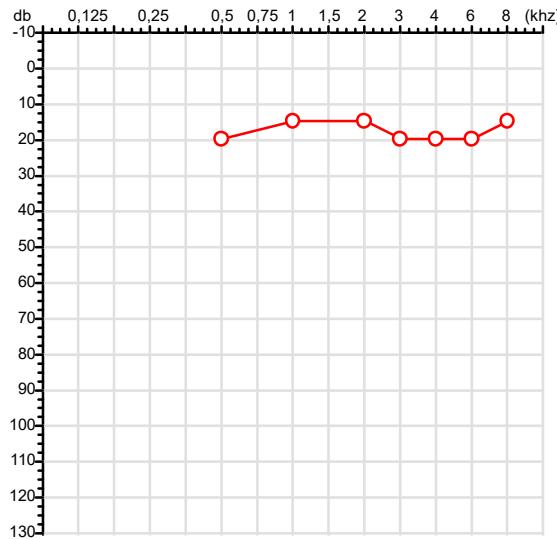
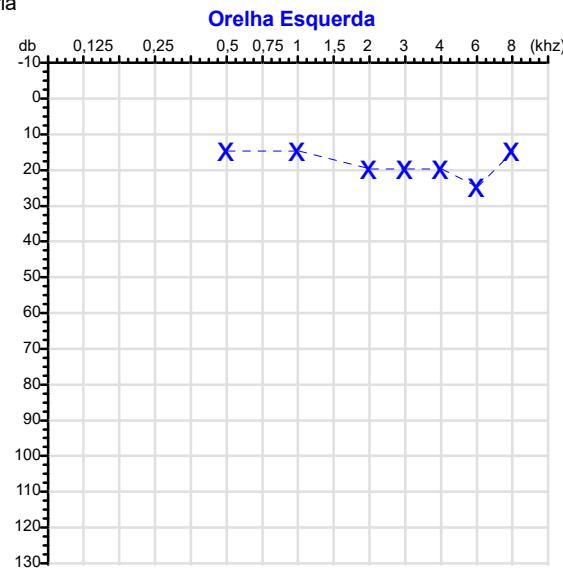
CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :624DAE59ECC67598C82ABAFC2DA935EE9  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :006.944.621-01  
 CNPJ :78.958.717/0005-61  
 Nascimento :02/06/1982  
 Motivo :Periódico  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 17/11/2025

Paciente :Gilmar de Souza Rodrigues  
 Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
 Idade : 43 anos  
 Setor :GHE 16 CARREGAMENTO - OPERADOR DE GUINDASTE  
 Função :OPERADOR DE GUINDASTE

RG :/

**Orelha Direita****Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	20	15

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	20	20

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :4BA091E74F30359E139C72F7B818E1E4

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Gilmar de Souza Rodrigues*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



Protocolo : 251117084234 Data : 17/11/2025

Paciente : GILMAR DE SOUZA RODRIGUES

Nasc.: 02/06/1982 RG : -

CPF: 00694462101

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=690662271314320217320648540527>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR

