

Exame n.º :780183


CPF :903.924.421-91
CNPJ :23.514.747/0001-63
Nascimento :03/03/1981
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 21/11/2025

Paciente :Clediney Jose Botelho
Razão :CONESUL SOLUCOES E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Idade : 44 anos
Setor :PADARIA
Função :ASSISTENTE DE PRODUCAO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

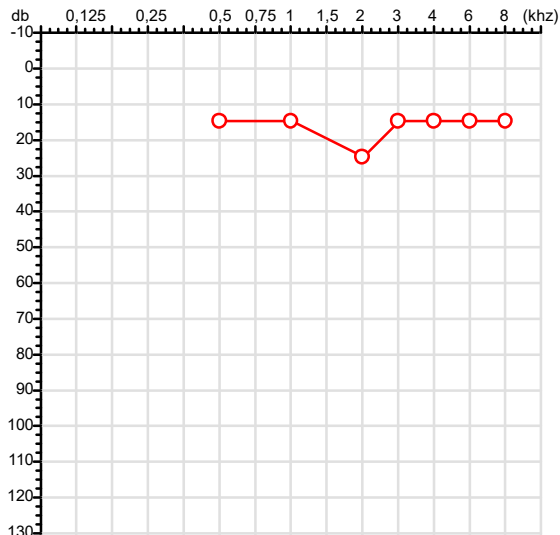

Orelha Esquerda

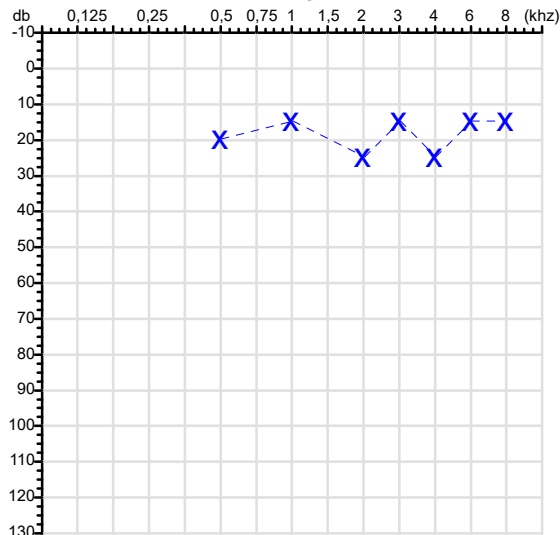

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	25	15	15	15	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	25	18	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	25	15	25	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	25	20	15	25	15	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes
Médica
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :26B4750D50C10688366FF6B97ACC8FC6

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Clediney Jose Botelho

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 21/11/2025
Primeiro Nome: CLEDINEY JOSE
Sobrenome:
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 78.0

Data de nascimento: 03/03/1972
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

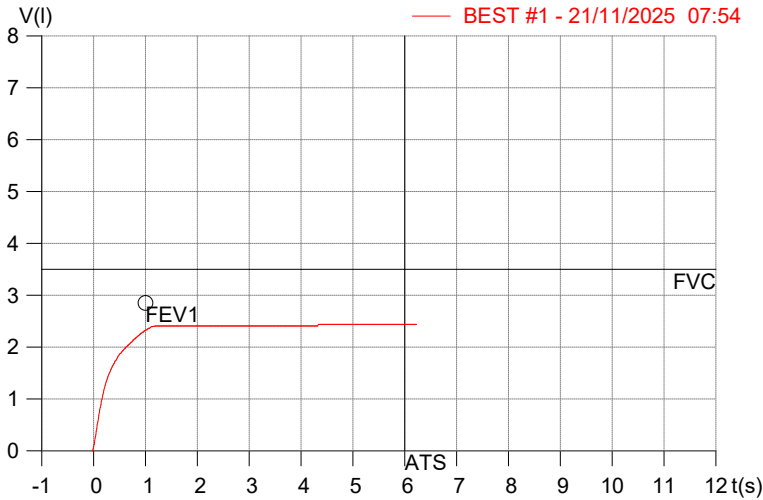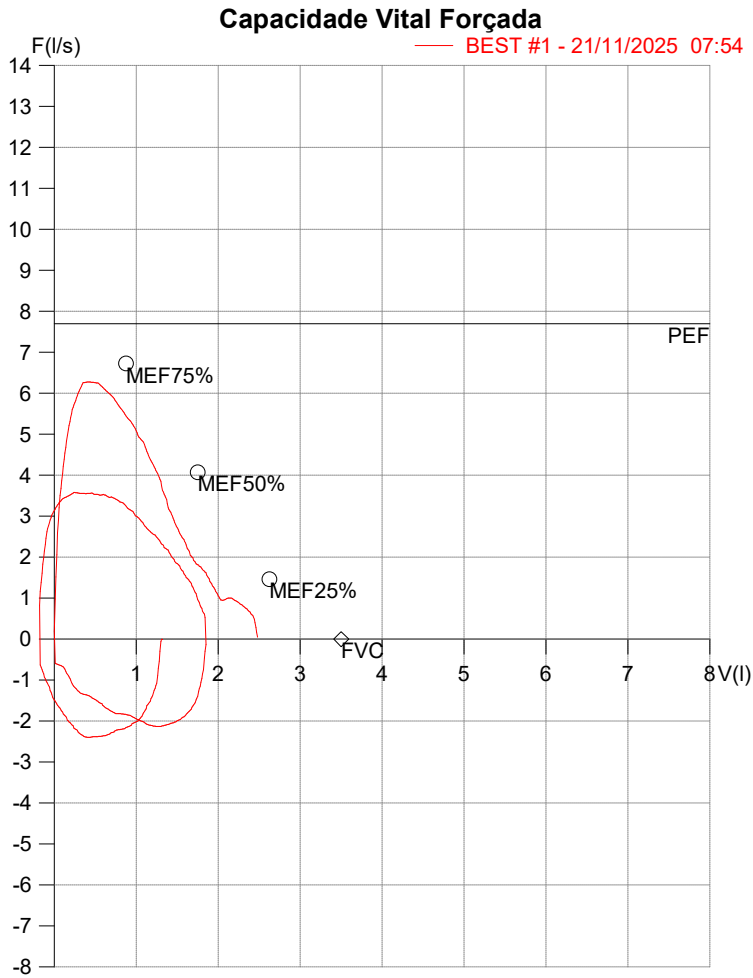

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.50	2.50	71.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.50	2.50	71.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.85	2.36	82.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.70	6.28	81.6
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	77.7	94.6	121.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.53	3.27	92.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.73	6.03	89.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.07	4.08	100.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.46	1.56	107.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		4.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	461.7	376.7	81.6

Diagnóstico:
Anormalidade moderado