


Exame n.º :780662

CPF :714.986.451-19
CNPJ :10.866.985/0002-77
Nascimento :27/01/1994
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 24/11/2025

Paciente :Maico Jose Alvarez Jaramello
Razão :GASPAR MAQUINAS E BOMBAS LTDA
Idade : 31 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE DE INSTALADOR (A) DE SISTEMA DE IRRIGACAO

RG :/

Orelha Direita

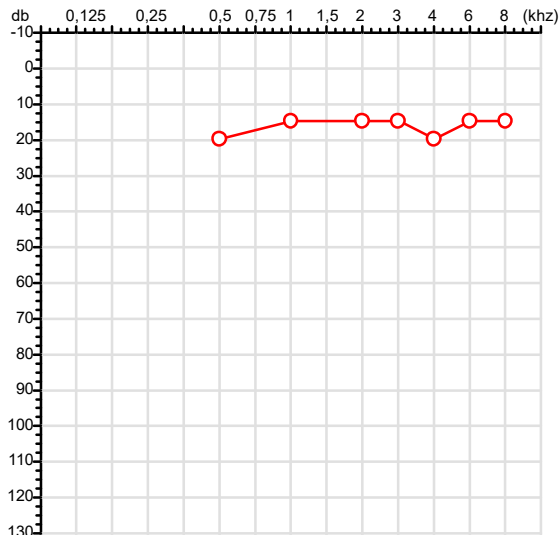

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	15	15

Óssea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	15	17


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

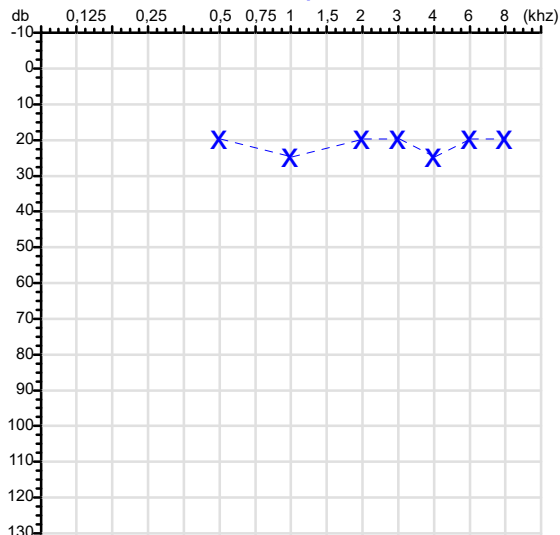

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	20	20	25	20	20

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	20	22	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes
Médica
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :7AC721F7058FF2E74C4843F458DD3094

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Maico Jose Alvarez Jaramello

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 24/11/2025
Primeiro Nome: MAICO JOSE
Sobrenome: JARAMELLO
Altura (cm): 170.0
Peso (kg): 72.0

Data de nascimento: 27/01/1994
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

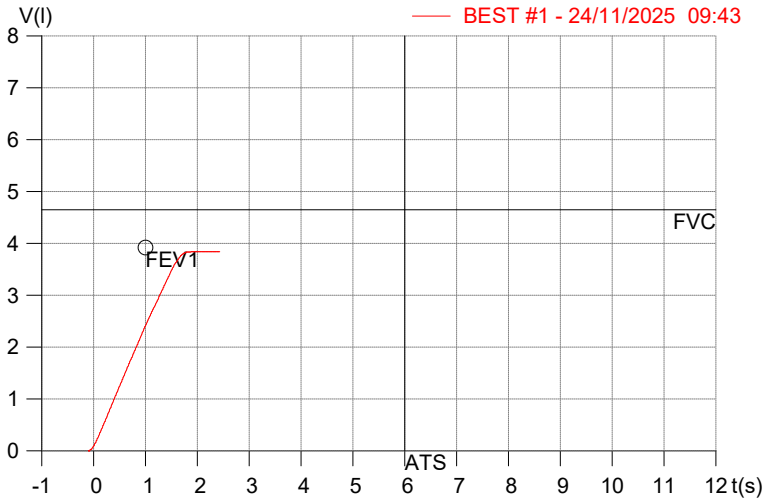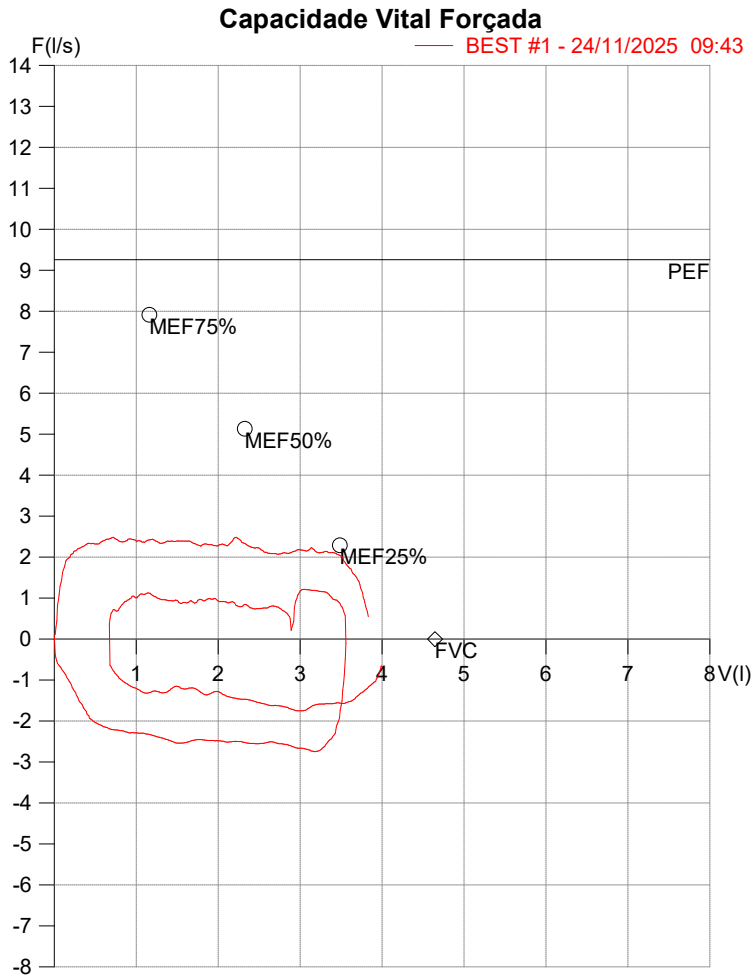

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.65	3.86	83.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.65	3.86	83.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.92	2.39	60.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.26	2.48	26.8
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.6	61.8	75.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.67	2.29	49.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.91	2.43	30.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.13	2.30	44.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.29	2.10	91.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	555.3	148.9	26.8

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado