

Exame n.º :781076


CPF :695.411.831-15
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :04/12/1973
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 25/11/2025

Paciente :Joao Farias de Oliveira
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 51 anos
Setor :ALVENARIA
Função :PEDREIRO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

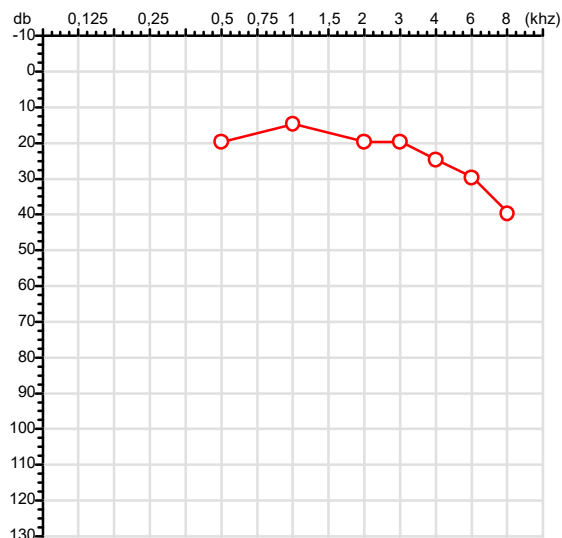

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	30	40

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	30	25

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

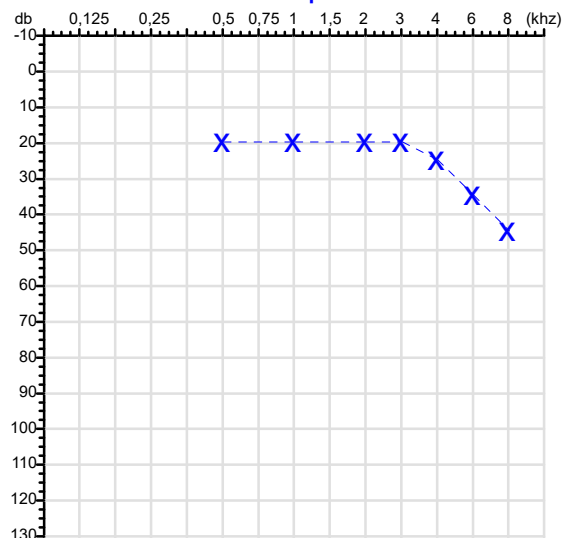

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	25	35	45

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	25	35	27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2E019FEC9D41391B49AB17A292C8C83D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joao Farias de Oliveira

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 781076
Primeiro Nome: JOAO FARIAS DE
Sobrenome: OLIVEIRA
Data: 25/11/2025

Data de nascimento: 04/12/1973
Sexo : Macho
Peso (kg): 58.0
Altura (cm): 165.0

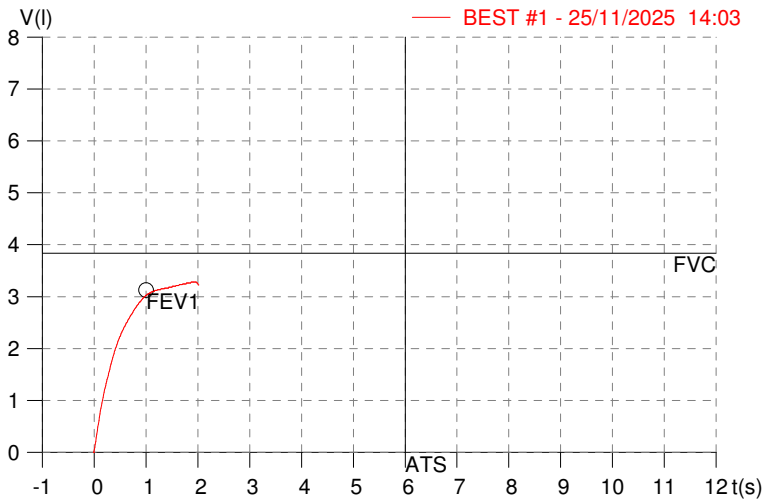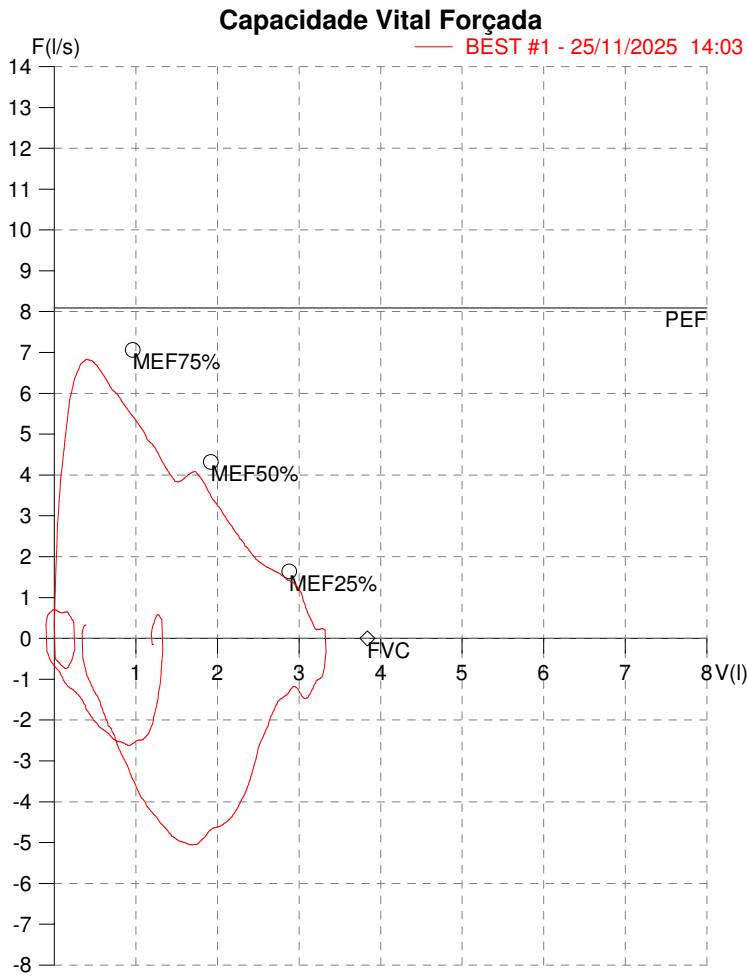

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.84	3.34	86.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.84	3.34	86.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.13	3.06	97.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.09	6.83	84.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.05	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	78.0	91.7	117.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.71	3.46	93.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.06	5.80	82.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.32	4.07	94.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.64	1.92	116.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	485.3	409.9	84.5

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 25/11/2025