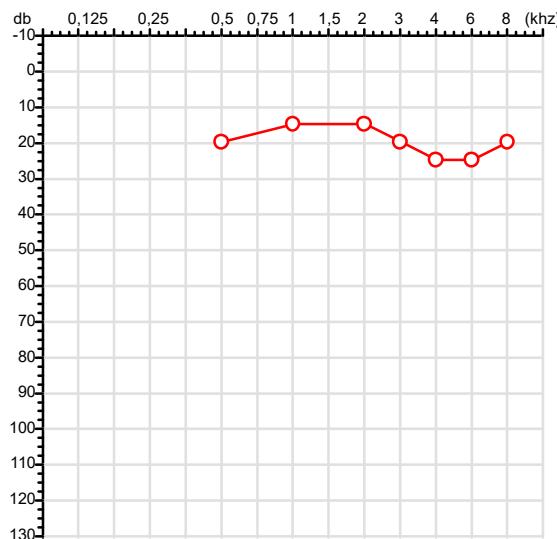
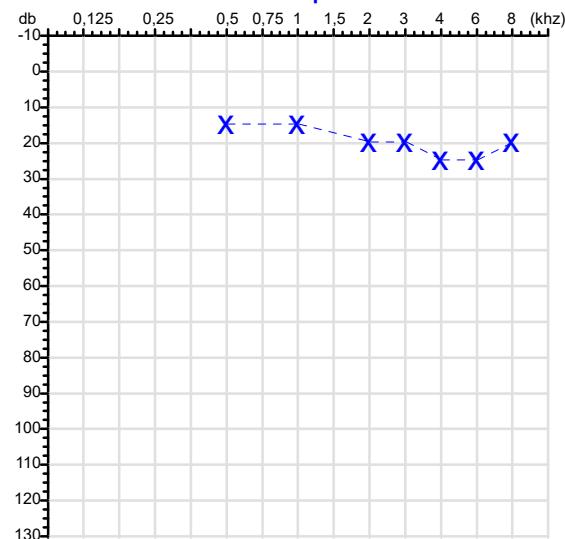


CPF :016.666.311-59
 CNPJ :53.193.433/0001-77
 Nascimento :07/04/1980
 Motivo :Periódico
 Repouso :14h
 Data do Exame : 10/12/2025

Paciente :ELIANO BATISTA ASSIS DOS SANTOS
 Razão :CONCREMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
 Idade : 45 anos
 Setor :PRODUCAO
 Função :PRODUCAO DE PRE MOLDADO

RG :/

Orelha Direita**Orelha Esquerda****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :02E76F031A9E7527C2886AF5A49AC6AA
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Eliano Batista Assis Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Data da Visita	10/12/2025
Impresso em	10/12/2025

Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
ELIANO BATISTA ASSIS DOS SANTOS		783800	Masculino	45,6	55,00	170,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m ²)	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	07/04/1980	--	19,0	Não	--	--
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
--		--			Outros/Não Especificado	

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



09:41

Posição do Teste

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	1,72	4,22	41
FEV1	L	1,39	3,42	41
FEV1/FVC%	%	80,9	81,2	100
FEV1/Vcmax%	%	80,9	81,2	100

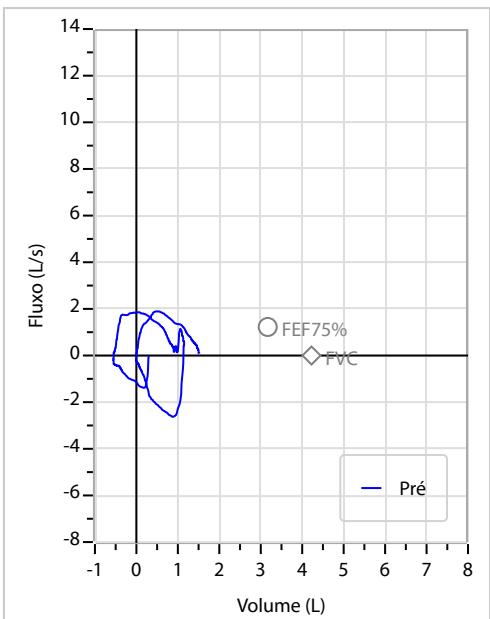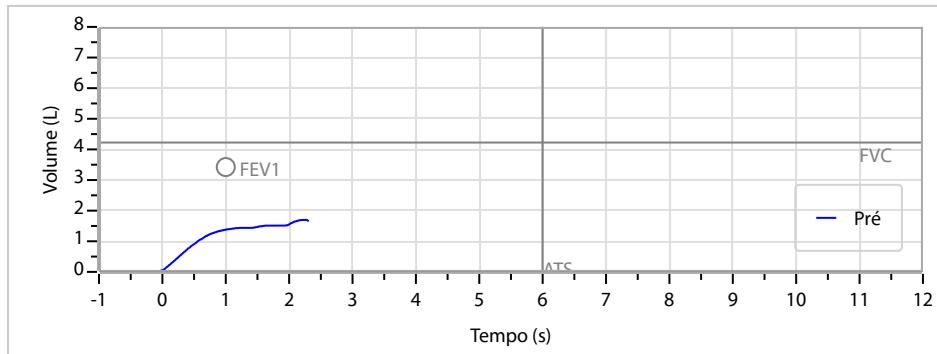

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 80,9% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 1,72 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____