


Exame n.º :784643

CPF :128.533.521-02
CNPJ :10.866.985/0002-77
Nascimento :28/04/1997
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 15/12/2025

Paciente :Adrian Antonio Villarroel Brito
Razão :GASPAR MAQUINAS E BOMBAS LTDA
Idade : 28 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE DE INSTALADOR (A) DE SISTEMA DE IRRIGACAO

RG :/

Orelha Direita

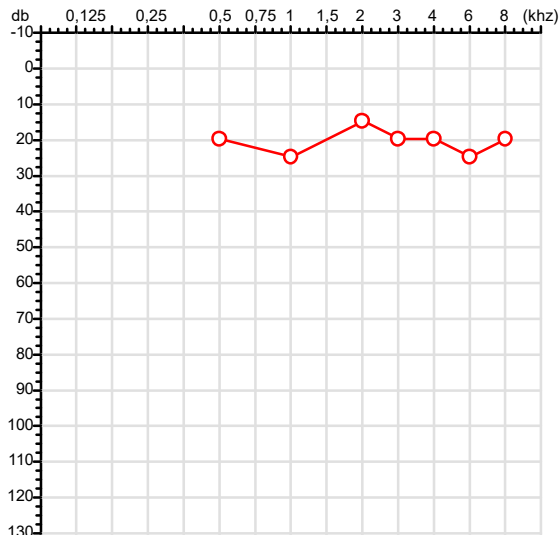

Aérea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	15	20	20	25	20

Ossea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	15	20	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

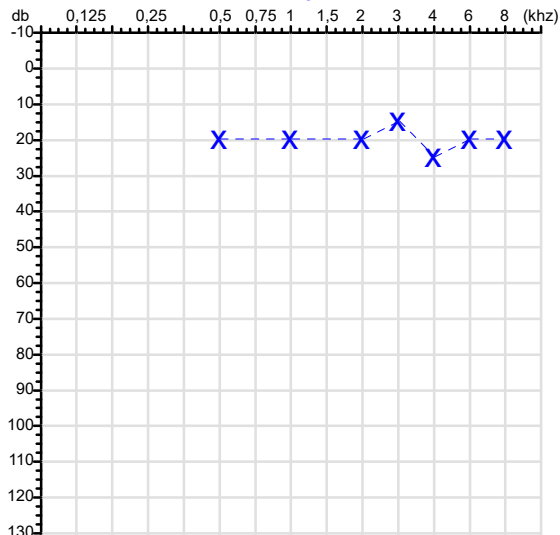

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	15	25	20	20

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	15	25	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dr. Ericki A. Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :0A33AB2D580731CD7CD94746F9BB7C65

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Adrian Antonio Villarroel Brito

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 15/12/2025
Primeiro Nome: ADRIAN ANTONIO
Sobrenome: VILLARROEL BRITO
Altura (cm): 175.0
Peso (kg): 71.0

Data de nascimento: 28/04/1997
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: GASPAR M. E BOMBAS
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 15/12/2025 09:06

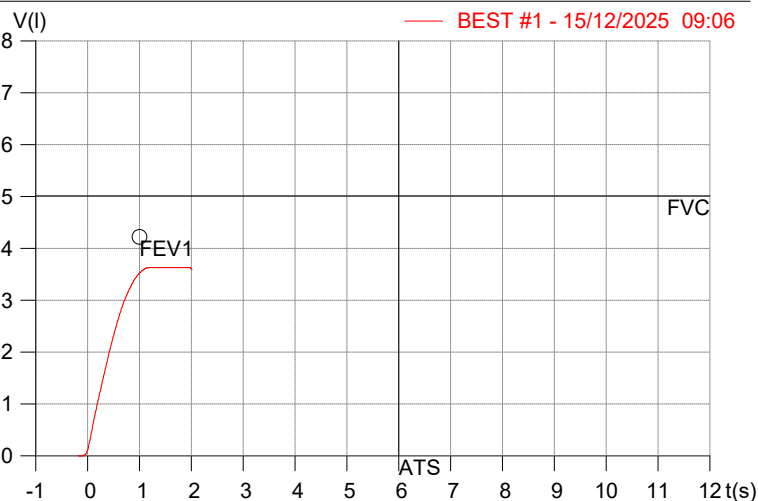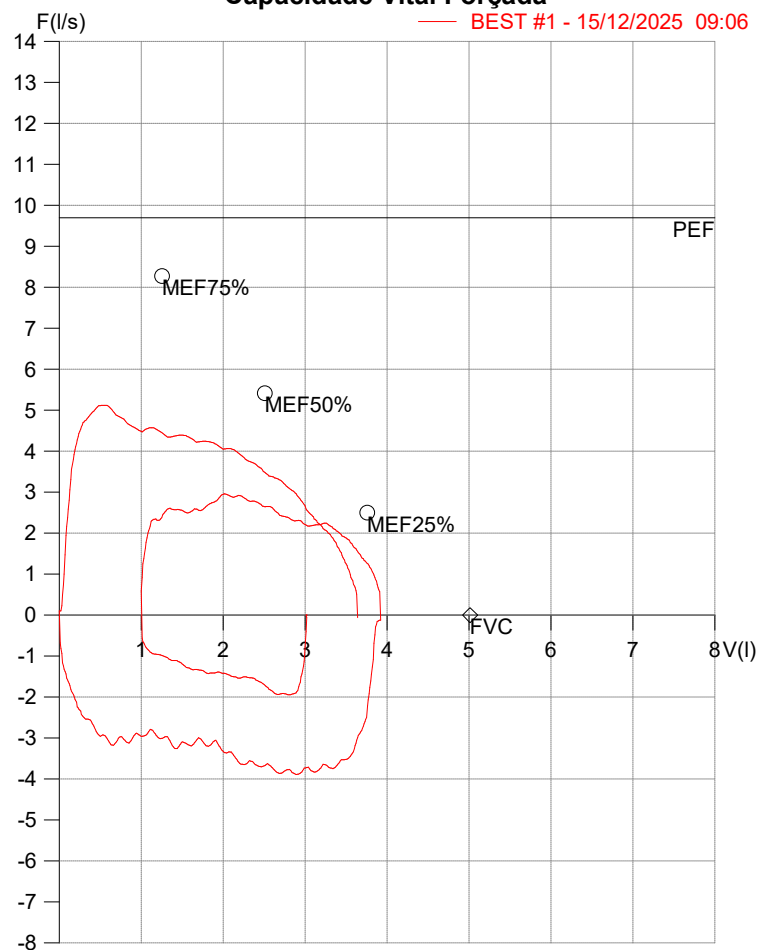

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.01	3.65	72.8
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.01	3.65	72.8
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.22	3.53	83.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.69	5.12	52.8
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.2	96.6	117.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.89	4.05	82.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.27	4.58	55.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.41	4.23	78.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.50	3.24	129.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	581.5	307.0	52.8

Diagnóstico:
Espirometria normal