


Exame n.º :785038


CPF :258.261.128-08
 CNPJ :02.679.787/0001-95
 Nascimento :27/02/1977
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 16/12/2025

Paciente :MAURICIO DA SILVA ANDREASSA
 Razão :INBRAC INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA
 Idade : 48 anos
 Setor :GERAL
 Função :GERENTE DE OBRAS

RG :266238798/SSPSP

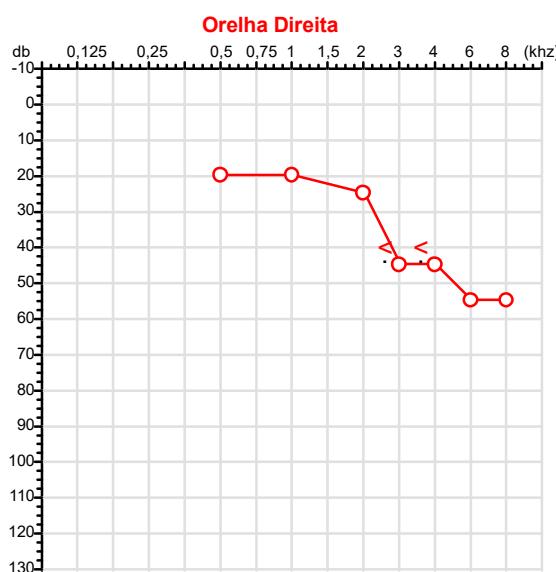

Audiometria

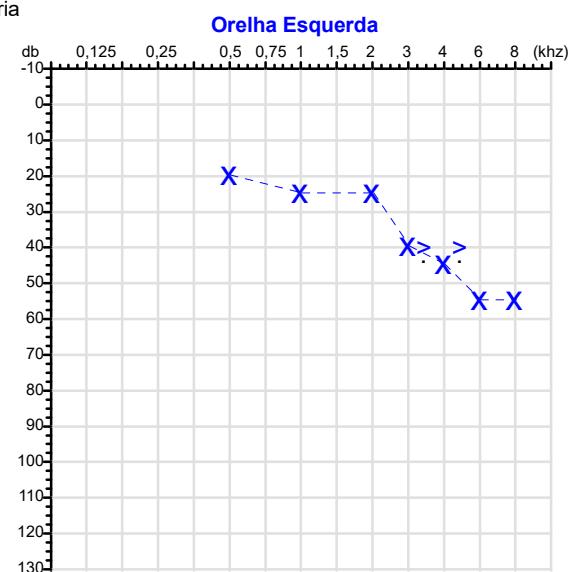

Áerea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	45	45	55	55

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG


Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	45	45	55	48

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :4AFEB381973E309DEF52EF1F55F8B0B6

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	25	40	45	55	55

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	25	23	40	45	55	47

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Mauricio da Silva Andreassa

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2025

Data da Visita	16/12/2025
Impresso em	16/12/2025

Nome	MAURICIO DA SILVA ANDREASSA	ID1	785038	Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
Agrupamento	--	D.O.B.	27/02/1977	ID2	--	BMI (kg/m ²)	Fumante
Técnico	--	Médico	--	--	31,5	Não	Anos de Tabag... Cig/Dia

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



Posição do Teste

11:32

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,10	4,77	86
FEV1	L	3,73	3,80	98
FEV1/FVC%	%	90,9	80,0	114
FEV1/Vcmax%	%	90,9	80,0	114

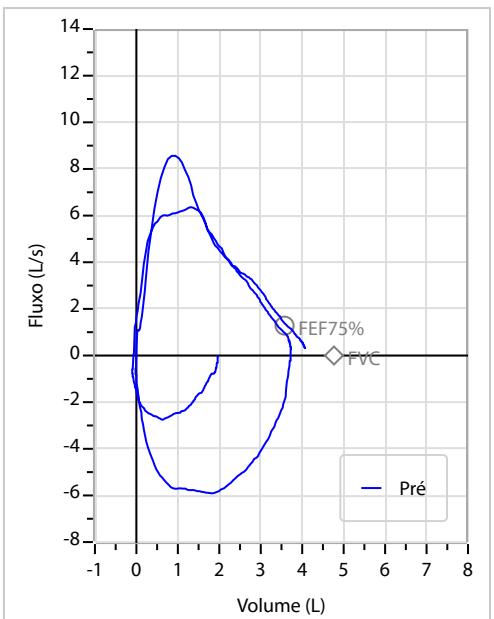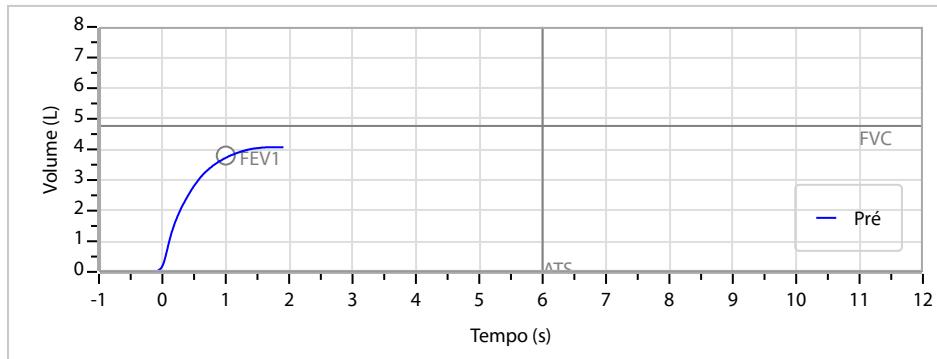

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 90,9% e um valor FVC de 4,10 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____