



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 43201006000130 Fantasia : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Razão Social : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA N.º 6520 Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT COSTA CEP : 78080535

### Funcionário

Nome : Paulo Henrique da Silva Santos	Setor: PRODUCAO
CPF : 06247277180	Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : /	Nascimento: 20/12/2001

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

<b>SEM CORREÇÃO</b>	<b>COM CORREÇÃO</b>
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 15 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

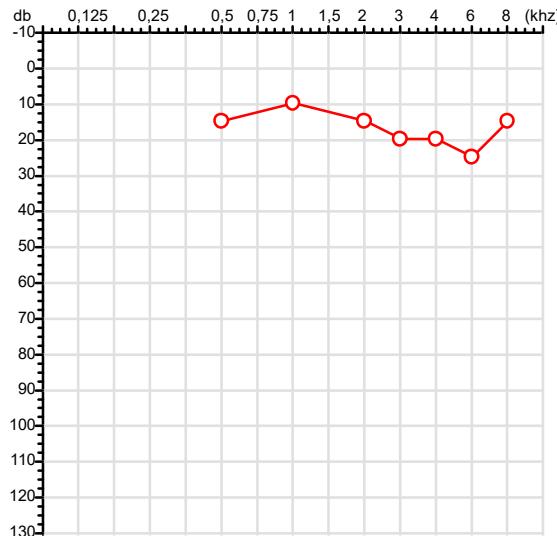
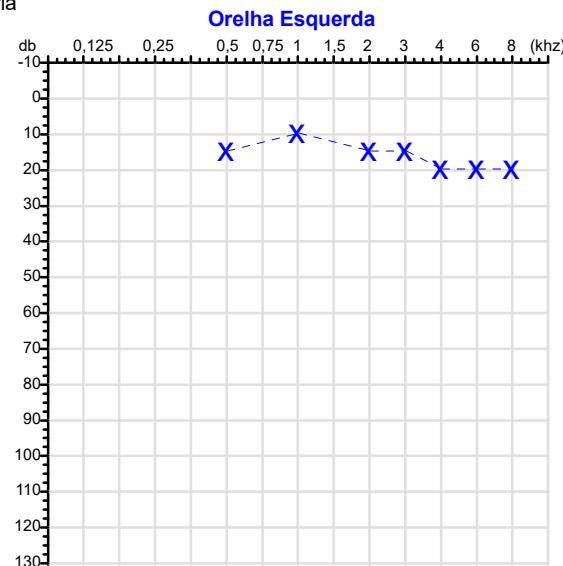
Autenticação Assinatura :0408C401B9F9756EA39B1D5362064810  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :790955

CPF :062.472.771-80  
 CNPJ :43.201.006/0001-30  
 Nascimento :20/12/2001  
 Motivo :Demissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 15/01/2026

Paciente :Paulo Henrique da Silva Santos  
 Razão :CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
 Idade : 24 anos  
 Setor :PRODUCAO  
 Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

**Orelha Direita**

**Audiometria**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	20	20	25	15

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG


**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	20	20	25	22

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

  
**Emanuel Sempio**  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :1193CEDC12ED7B4DE4D7DB30C3872312  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Paulo Henrique da Silva Santos

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Protocolo : 2601151133599

Data : 15/01/2026

Paciente : PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS

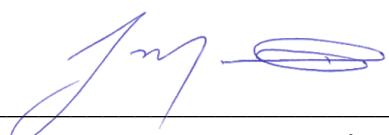
Nasc. : 20/12/2001 RG : -

CPF : 06247277180

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.



Dr. Leandro M. Colmanetti  
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

