



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 92930643000152 Fantasia : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Razão Social : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Endereço : R FELICÍSSIMO DE AZEVEDO N.º 925

Complemento :

Cidade / UF : PORTO ALEGRE / RS

CEP : 90540110

Funcionário

Nome : Carla Monique Miranda da Mata

Setor: GHE 01 - OBRAS CAMPO GRANDE/MS

CPF : 05105084136

Cargo: ENGENHEIRA AMBIENTAL

RG : /

Nascimento: 16/04/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 21 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

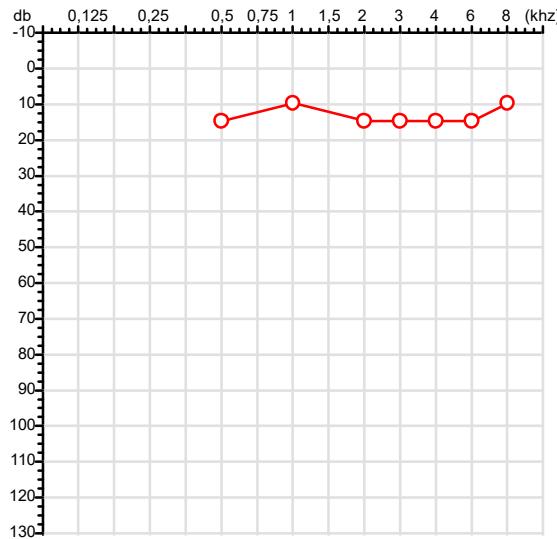
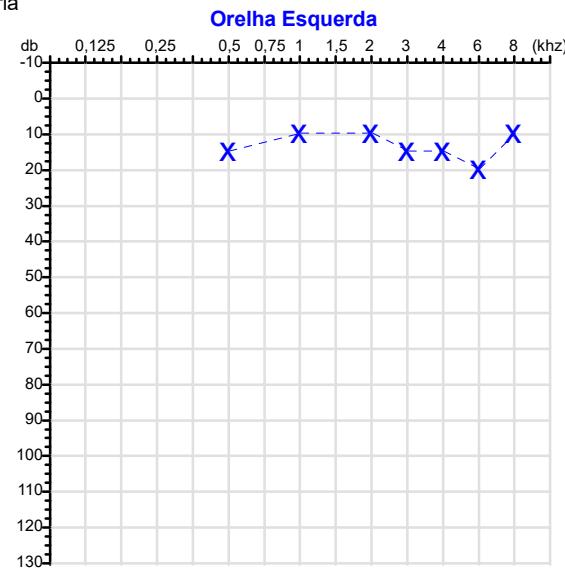
Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assinatura :E1B6623CB65ACF5E9DEA21A7D0C94572
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :051.050.841-36
 CNPJ :92.930.643/0001-52
 Nascimento :16/04/1993
 Motivo :Periódico
 Repouso :14h
 Data do Exame : 21/01/2026

Paciente :Carla Monique Miranda da Mata
 Razão :ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
 Idade : 32 anos
 Setor :GHE 01 - OBRAS CAMPO GRANDE/MS
 Função :ENGENHEIRA AMBIENTAL

RG :/

Orelha Direita**Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	15	10

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :46D997D7DB72FD53087A157259ED36E7
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Carla Monique Miranda da Mata

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)