

Exame n.º :794420


CPF :924.321.741-00
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :04/08/1982
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 23/01/2026

Paciente :Gheyson Bromenchenque da Conceicao
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 43 anos
Setor :TOPOGRAFIA
Função :ENCARREGADO DE TOPOGRAFIA

RG :13677209/SSP/MT

Audiometria

Orelha Direita

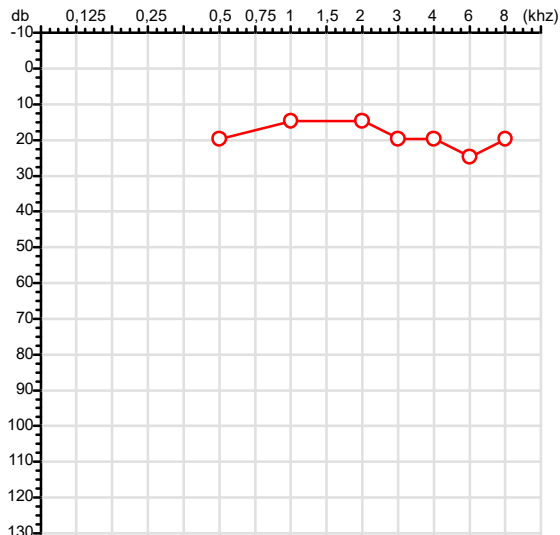

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

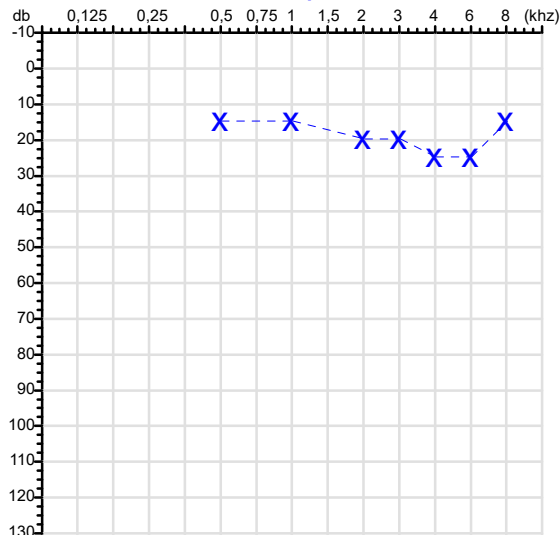

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :90E701759F42513B2D106AFA8AFD4DFB

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Gheyson Bromenchenque da Conceicao

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2025

Nome	GHEYSON BROMENCHENQUE DA CONCEICAO		ID1	794420	Sexo	Masculino	Idade	43,4	Peso (kg)	86,00	Altura (cm)	175,0
Agrupamento	--	D.O.B.	04/08/1982	--	BMI (kg/m2)	28,1	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
07:45	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,70	4,58	81		
FEV1	L	3,44	3,71	93		
FEV1/FVC%	%	93,1	81,2	115		
FEV1/Vcmax%	%	93,1	81,2	115		

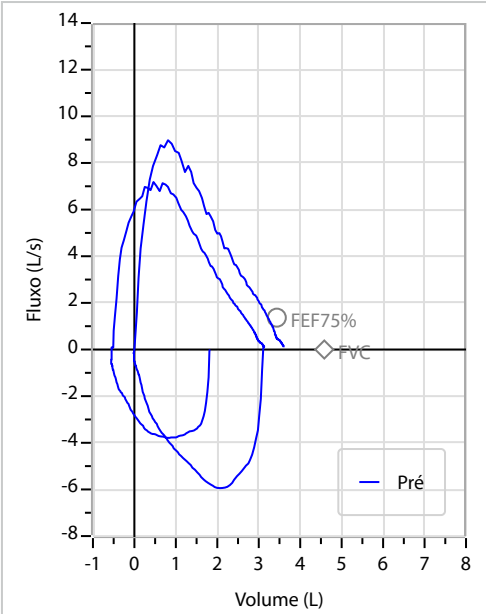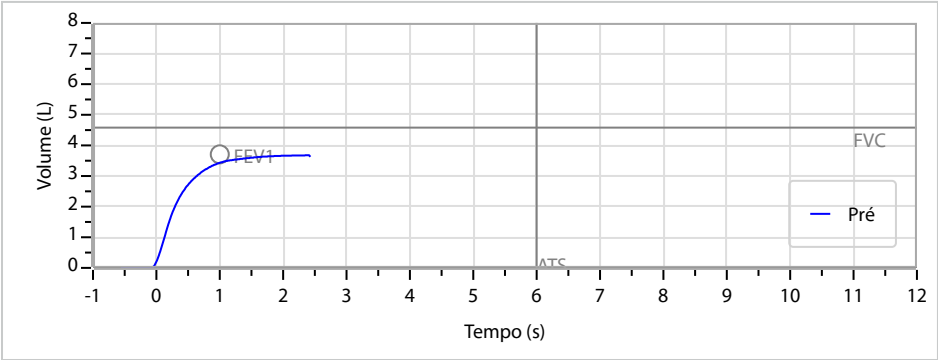

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 93,1% e um valor FVC de 3,70 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____