

# Exame n.º :794481


CPF :032.431.191-54  
CNPJ :52.584.112/0001-30  
Nascimento :12/10/2001  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 23/01/2026

Paciente :Kauany Thaiany Pratis Castrillon  
Razão :VRG ASSESSORIA SP LTDA  
Idade : 24 anos  
Setor :GERAL  
Função :OP. DE TELEMARKETING

RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita

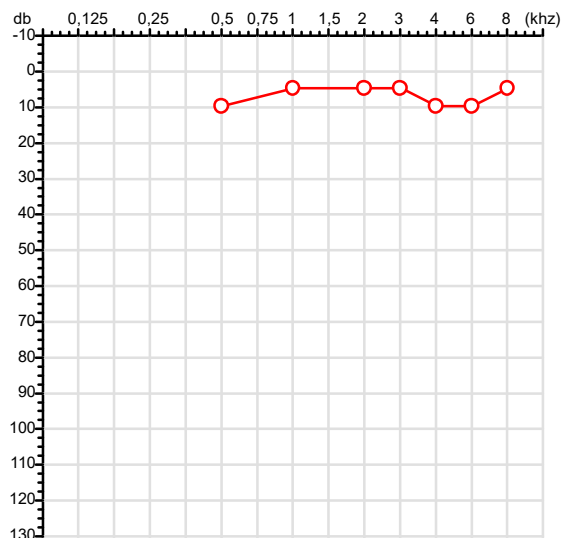

### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4  | 6  | 8 |
|-------|------|-----|---|---|---|----|----|---|
| OD db | NDG  | 10  | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 |

### Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais


| Khz   | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4  | 6  | = |
|-------|-----|---|---|---|---|----|----|---|
| OD db | 10  | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda

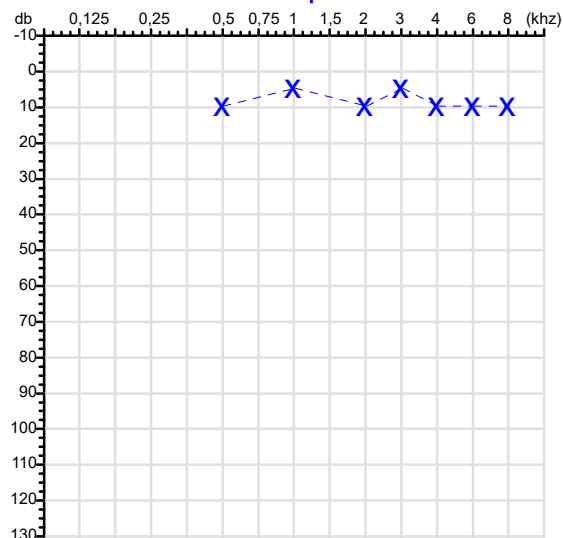

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1 | 2  | 3 | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|---|----|---|----|----|----|
| OE db | NDG  | 10  | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1 | 2  | = | 3 | 4  | 6  | = |
|-------|-----|---|----|---|---|----|----|---|
| OE db | 10  | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E31D2F9783BE17125E74090D61C5F951

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Kauany Thaiany Pratis Castrillon*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025