
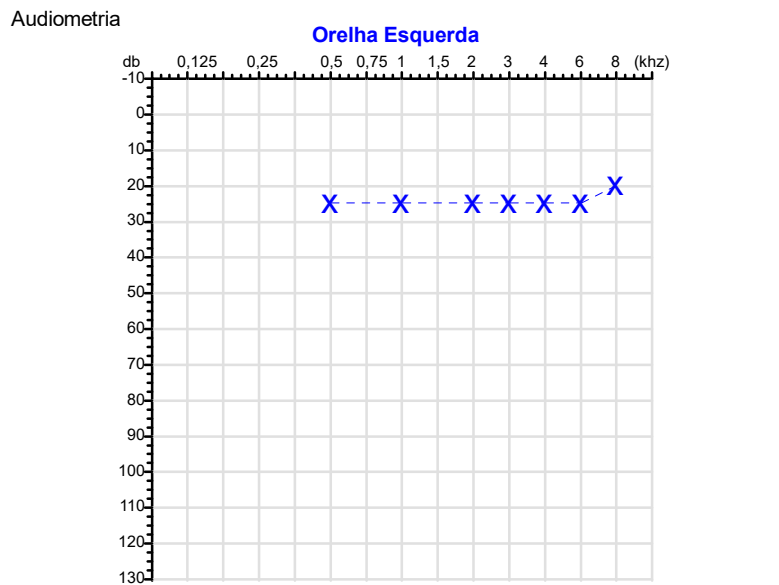


# Exame n.º :797264

CPF :011.433.920-19	Paciente :Fabricio Leonardo da Silva	RG :1078348396/SJ RS
CNPJ :92.765.833/0001-61	Razão :LIESS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	
Nascimento :14/12/1985	Idade : 40 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :COORDENADOR (A) DE PROJETOS	
Data do Exame : 02/02/2026		

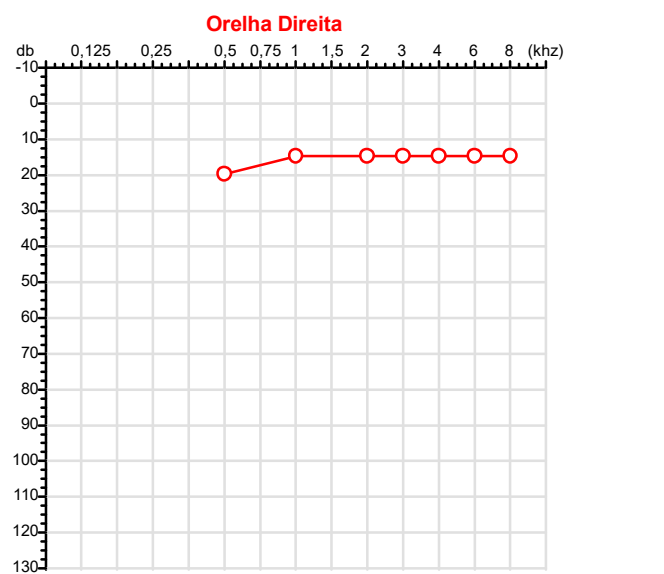

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	15	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	25	25	25	25	20

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	15	15	15


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	25	25	25	25	25	25	25

**Laudo Clínico OD**  
Audição normal

**Laudo Clínico OE**  
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

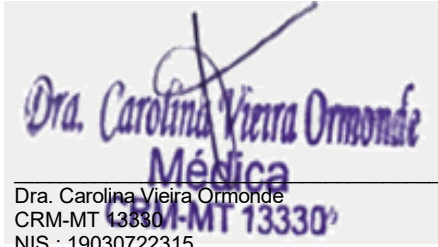

Dra. Carolina Vieira Ormonde  
Médica  
CRM-MT 13330  
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :794E73653E33724C91B826C4C225A2F9  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Fabricio Leonardo da Silva*  
\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC  
Última Aferição :12/08/2025